

# Technické parametry pro specifikaci tlakového stonkového teploměru:

## Pouzdro

Rozměr pouzdra		Kód A
Průměr	Výška	
63	45	1
80	45	2
100	50(85)	3
160	50(100)	4

Teplotní rozsahy °C	Kódy	
	B	C
-40-0+40	0	1
-40-0+60	0	2
-30-0+50	0	3
-25-0+75	0	3a
-20-0+40	0	4
-20-0+60	0	5
-20-0+80	0	5a
0-60	0	6
0-80	0	7
0-100	0	8
0-120	0	9
0-160	1	0
0-200	1	1
0-250	1	2
0-300	1	3
0-350	1	4
0-400	1	5
0-500	1	6
0-600	1	7

Provedení pouzdra	Kód D
Ocel	1
Ušlechtilá ocel	2

Příslušenství	Kód E
Žádné	0
Kompenzační	1
Glycerinové tlumení	2
Silikonové tlumení	3
S magnetickými kontakty	4
S indukčními kontakty	5
S elektronickými kontakty	6
Ukazovací ručička pevná	7
Vlečná ručička maxima	8

Kontakty: min./max. nebo kombinace.

## Stonek

Délka stonku [mm]	Kód F
125	1
160	2
200	3
250	4
315	5
400	6
500	7
1000	8

Průměr stonku [mm]	Kód G
6	1
8	2
10	3
12	4
15	5

Připojení stonku	Kód H
Spodní	1
Zadní	2
Nastavitelné	3

## Stonek

Zahnutí stonku	Kód I
Rovné	1
Doleva	L
Doprava	P
Dozadu	3


Ukončení stonku	Kód J
Hladké	0
Ořech	1
Vnější závit	2

Závit na stonku	Kód K
Žádný	0
G 1/2	1
G 3/4	2
G 1	3
M18x1,5	4
M20x1,5	5
M24x1,5	6
M27x2	7

Provedení stonku	Kód L
Mosaz	1
Nerez 1.4571	2

Typ jímky	Kód M
Žádná	0
Posuvné záv.hrdlo	1
Standardní jímka	2
Vysokotlaká jímka	3

Závit na jímce	Kód N
G 1/2	1
G 3/4	2
G 1	3
M 18x1,5	4
M 20x1,5	5
M 24x1,5	6
M 27x2	7

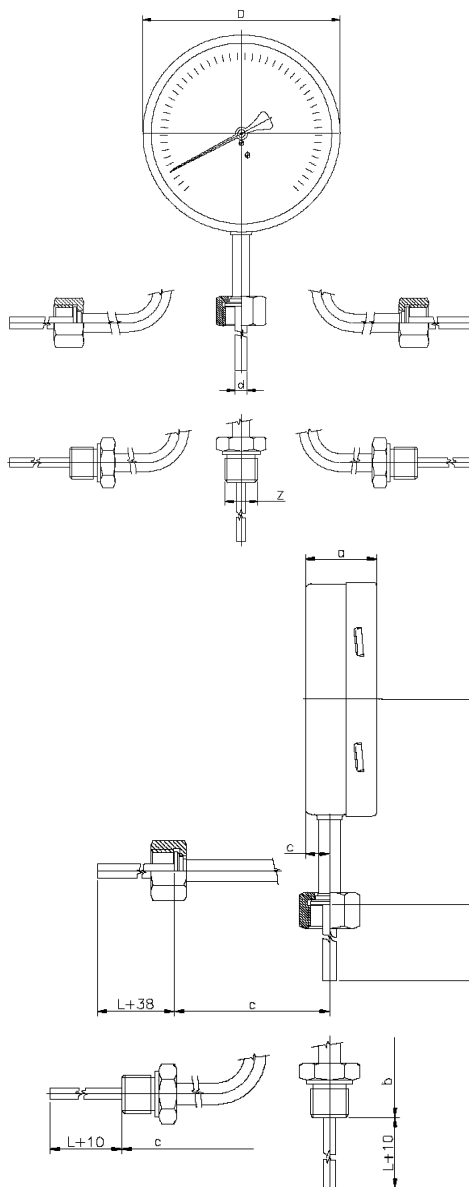

# eximus<sup>®</sup> cs S.R.O.


IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, [www.eximus.cz](http://www.eximus.cz), [eximus@eximus.cz](mailto:eximus@eximus.cz)

Čapkova 22  
678 01 Blansko  
Česká republika  
Tel.: +420 - 516 432 999  
+420 - 516 432 680  
+420 - 516 433 701  
Fax: +420 - 516 432 999


Příklad značení Německým výrobcem, podle kterého je možné vybrat Vaši specifikaci požadavku:  
<http://www.pfoertner-messtechnik.de/gasexpansion-thermometers/gasexpansion-thermometers.htm>

Zapojení kontaktů (250V / 30W):

**Schéma 1.**

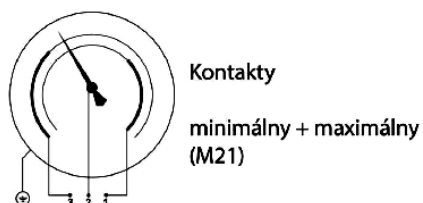

**Schéma 2**

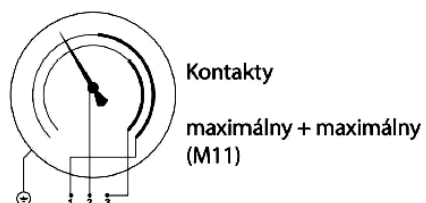

**Schéma 3**

